德语German(DE),

西班牙Spanish(Spain)Es

法语French(Europe)FR

意大利语（IT）

日语（JP）

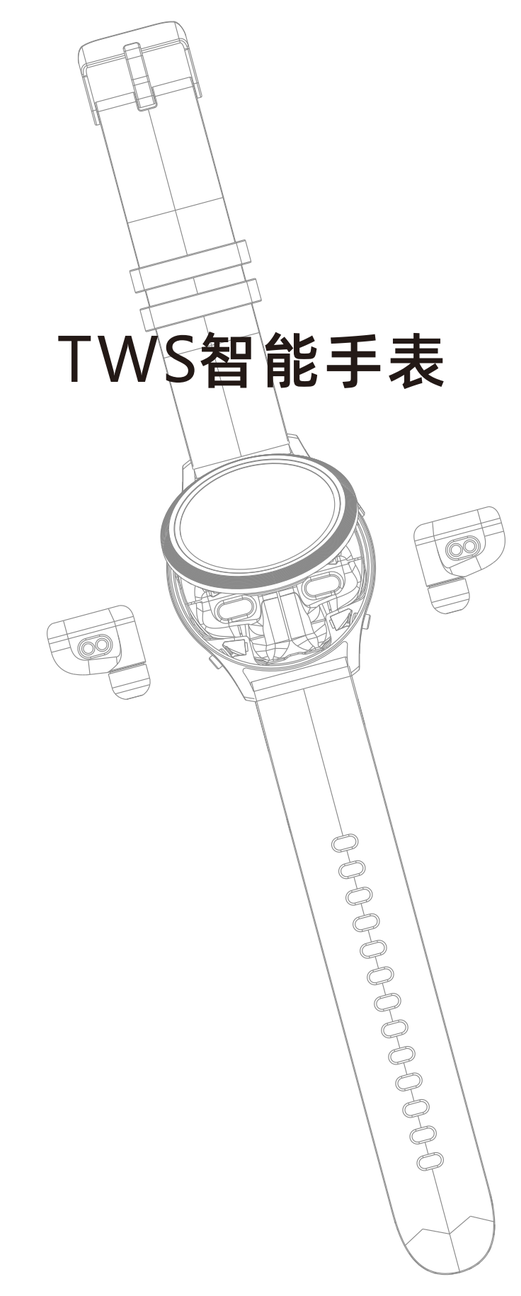

TWS智能手表

用户使用指南

一、外观说明

1.整机介绍

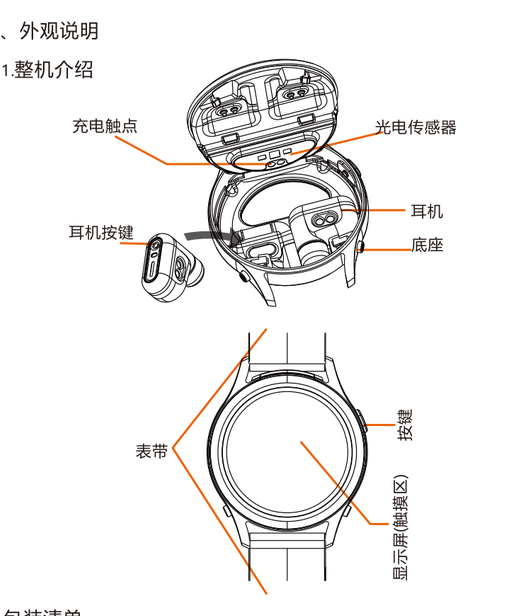

2.包装清单
手环表带×1 充电线×1 包装盒×1
蓝牙耳机X1 备用耳机头X2 用户使用指南×1

二、初次使用说明

1.设备功能界面介绍
开机后进入时间界面，上下左右划动进入相应菜单

2.在主界面状态下按按键可进入子菜单，共用三种菜单风格可供选择

3.软件下载，安装APP：

安卓手机可扫描二维码，或在各任用市场中搜索"FitCloudPro"进行下载安装

苹果手机可扫描二维码，或进APP Store 搜索"FitCloudPro"进行下载安装

4.手环与耳机蓝牙连接（此手环为双蓝牙连接,耳机/手环需各连一次）

耳机蓝牙连接如下：

1）打开手环蓝牙：将耳机从手环中取出来，手环的蓝牙将会自动打开。

2）接下来打开手机，点设置，打开蓝牙，手机蓝牙将自动搜索手环蓝牙号，在下方可用设备中找到手环的蓝牙号 "X-Audio-i",点击进行配对，完成耳机的蓝牙连接

手环蓝牙连接如下：

打开手机APP" FitCloudPro "，在"设备"界面下"添加设备"搜索到设备型号"X17_mini"点击进行连接。连接成功后在APP的"设备"下会显示设备型号"X17_mini（已连接）"。

5.连接及配对注意事项
1)确保手机蓝牙为开启状态；
2)确保设备电量充足，使用前请先开机或充电；
3)配对连接时确保设备离手机50cm以内；
4)若在APP里搜不到设备,请在手机权限设置里检查是否允"FitCloudPro "使用蓝牙;
5)耳机配对时需确保耳机从手环底座中取出来。
6)若期间手环或手机有配对过其他蓝牙设备则需要重新连接。
7)如有多台X17_mini手环，在APP连接手环的时候，注意APP里手环蓝牙的ID地址是否与手环一致。

三、对耳的按键功能
1、配对前4击按键:中英文提示音切换;
2、长按2S开机，长1.5秒拒接电话，长按3秒关机;
3、双击按键-----接听/挂断电话;
4、4击按键---唤醒SIRI;
5、双击按键:播放/暂停；
6、三击左耳按键: 上一曲;三击右耳按键：下一曲
7、耳机恢复出厂设置：手机断开与耳机的连接，耳机从手表里拿出，快速双击并长按耳机5秒。(如双耳不能配对，可恢复出厂进行重新配对）

四、耳机功能使用说明及注意事项:
a.接听来电和挂断
若耳机在手环底座中时有来电, 从底座中取出来耳机并双击耳机按键即可接听。
b.拒接来电
当有来电时, 设备会震动并有显示提醒, 长按触摸区3秒可直接拒接，或者长按耳机按键3秒拒接。

五、主要功能介绍
*注 意:为确保数据有效, 请在APP的个人资料里输入真实的性别、身高和肤色。
A.运动监测
进入运动监测界面，显示当前步数、距离以及消耗的卡路里。
B.睡眠监测
进入睡眠监测界面，显示昨晚的总睡眠时间。
C.心率/血压/血氧测试
切换到心率/血压/血氧测试界面，手环背面的LED灯点亮，心率/血压/血氧开始测试，1-2分钟后显示当前心率/血压/血氧值，点击触摸区退出当前测试。也可以通过手机APP进行心率/血压/血氧单项或者全项目同时测试，同步测试数据，设置心率整点测量,以及打开心率报警开关。

血压测试方式方法:请保持测试时身体放松、静止, 确保手表与心脏同高（如右图）,测试时也请不要说话；

*本产品所测量的数据仅为参考数据，不能作为医学诊断数据，与医学诊断使用的血压趋势，心率非同一概念，请勿作为诊断、治疗使用。

D.查找手环
只需点击手机APP里的智能查找手环功能，便可以方便快捷的通过手环所发出的震动来辨别所在位置。

E.闹钟
在APP端的闹钟设置界面可设置闹钟, 设备会相应提醒。

F.信息提醒/推送
有新的信息时，设备会震动提醒并显示消息内容；对应的消息显示对应的图标。
注：请先将APP提醒开关打开；如需显示通知内容，也需在对应的即时工具设置为显示消息内容。

G.遥控拍照
通过APP进入"摇一摇拍照"界面，按触摸中间按键或者快速晃动手环遥控手机拍照。

H.女性健康

六、注意事项
1.禁止使用充电电压>5V,充电电流>2A的适配器。
2.禁止在有水渍的情况下充电。
3.本品支持防水。
4.本品为电子监测产品，不作为医疗参考，数据仅供参考；
5.剧烈运动时佩戴耳机可能会在运动时中脱落导致产品损坏或丢失。
6.光电传感器属高敏感元器件，要小心硬物碰伤。佩戴一段时间可能会有汗渍、灰尘 附着在表面可用软布定期清洁。
7.为确保驾驶安全，请不要在开车时拨打电话，若需使用X17_mini接听来电请务必在开车 前从手环底座中取出耳机戴上，勿在开车过程中做此操作。
8.在车上使用耳机功能请先在手机蓝牙设置里忽略与车载蓝牙的连接。
9.发现耳机充电不良，可能是耳机充电点有脏污或水渍，请用干棉签将充电点擦试干即可。

七、常见问题
Q:心率(睡眠)测试为什么不准?
A:首先手环设备是通过电子传感器来监测人体活动的，属于消费级产品出现一定的误差属正常现象，请客观对待数据。

Q:在哪里设置APP权限?
A:安卓手机-设置-权限管理-找到"FitCloudPro "应用-信任此软件。
1.如果手机安装了安全管理类或清理加速类应用，请将"FitCloudPro "设置为白名 单(信任名单)；
2.在手机系统的权限管理程序里，请将"FitCloudPro "设为信任应用，来电显示等功能需要获取权限来实现功能。

Q:来电，设备上有提醒，但接通后耳机里听不到声音?
A:来电时蓝牙耳机上会有延迟，可在响铃几声后再接听。若是通过手机接通来电，请在手机上检查语音通道是手机还是耳机，若是手机切换到耳机，默认遵循从哪个设备接通在哪个设备上接听的原则。

Q:我戴着耳机，但来电时听不到铃声?
A:请确保耳机和手机在有效的蓝牙连接距离内，若手机连过很多蓝牙设备，请在手机蓝牙设置里清除无效连接。

八、基本参数

主控芯片：RTL8762D	电池容量：205mAh+双25mAh
充电电压：5V	主体重：57g
充电电流：150mA	蓝牙版本：蓝牙5.0,蓝牙4.0
工作温度：-5~45 C	电池类型：聚合物锂电池

设备要求：
Android 4.4及以上系统手机，并支持蓝牙4.0及以上安卓手机
IOS8.0及以上系统，iphone 4S及以上苹果手机

此应用程序不是医疗设备。使用此应用程序期间获得的数据仅供参考，不应用于临床诊断、医学研究、诊断或治疗目的。

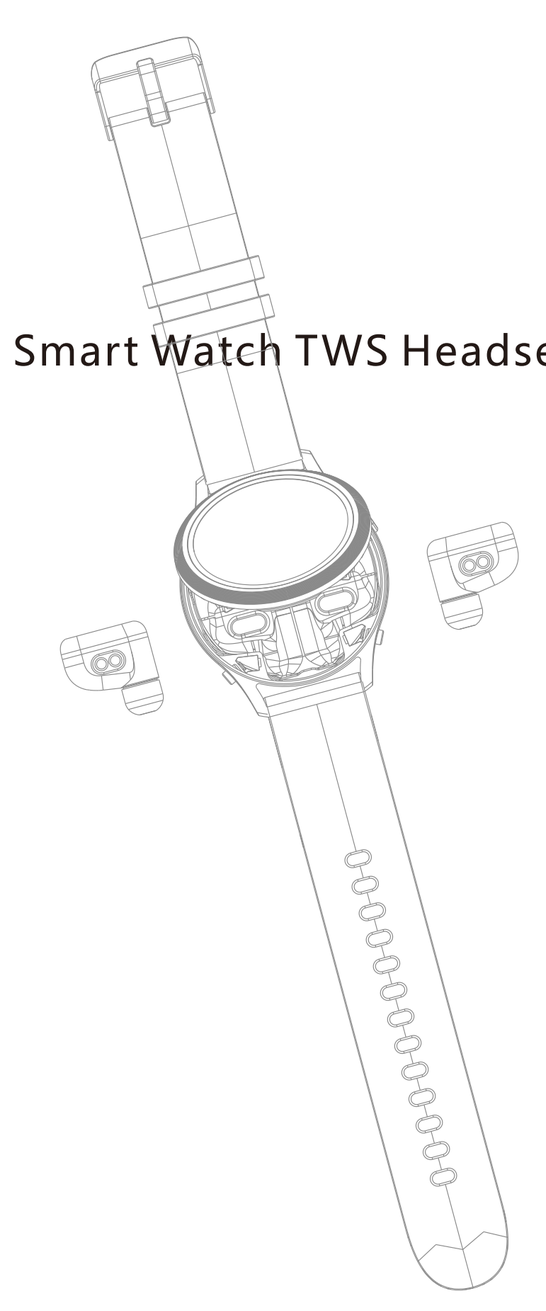

Smart Watch TWS Headset

Information to User

【1】For relevant electronic devices or peripheral devices, the instructions provided to users include the following or similar instructions:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

【2】Changes or modifications that are not explicitly approved by the regulatory responsible party may invalidate the user's device operation permissions. The example content is as follows:

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1 Appearance Description

1.1 Overall Introduction

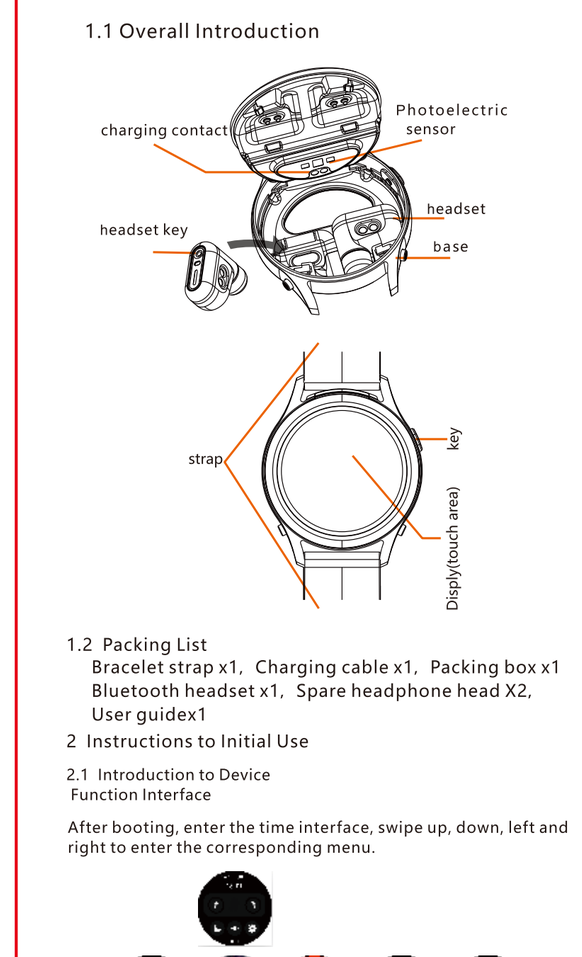

1.2 Packing List
Bracelet strap x1, Charging cable x1, Packing box x1
Bluetooth headset x1, Spare headphone head X2, User guidex1

2 Instructions to Initial Use

2.1 Introduction to Device Function Interface
After booting, enter the time interface, swipe up, down, left and right to enter the corresponding menu.

2.2 In the main interface state, press the key to enter the submenu, and three styles are available.

2.3 Software download, install APP:
Android phones can scan the QR code, or search for "FitCloudPro" in the application market to download and install.
Apple phones can scan the QR code, or search for "FitCloudPro" in the APPStore to download and install.

2.4 Bluetooth Connection between Bracelet and Headset(this device is dual Bluetooth connection, Headset/Bracelet need to be connected once both.)

(1)Headset Bluetooth connection is as follows.
a. Turn on the Bluetooth of the bracelet: Take the headset out of the bracelet,and the Bluetooth of thebracelet will automatically turn on.
b. Next, turn on the phone, click Settings, turn on Bluetooth, the phone's Bluetooth will automatically search for the Bluetooth number of the bracelet, find the Bluetooth number "X-Audio-i" of the bracelet in the available devices below,and click to pair to complete the Headset Bluetooth connection.

(2)Open the mobile APP "FitCloudPro", search for the device model "X17_mini" in "Add Device" under the "Device" interface, and click to connect. After the connection is successful, the device model "X17_mini (connected)" will be displayed under "Device" in the APP.

2.4 Notes on Connection and Pairing
(1) Ensure that the Bluetooth of the mobile phone is turned on;
(2) Ensure that the device has sufficient power, and please turn on or charge it before use;
(3) Make sure that the device is within 50cm of the mobile phone when pairing and connecting;
(4) If the device cannot be found in the APP, please check in the mobile phone permission settingswhether to allow "FitCloudPro" to use Bluetooth;
(5) When pairing the headset , make sure that the headset is taken out from the base of the bracelet；
(6) If the bracelet or mobile phone has been paired with other Bluetooth devices during the period,you need to reconnect；
(7) If there are multiple X17_mini bracelets, when the APP is connected to Bracelet, you should pay attention to whether the Bluetooth ID address is consistent with the bracelet .

3 Earphone touch button function
3.1.4 times of click before pairing - Chinese and English switch ;
3.2 Press for 2S to turn on, 1.5S to reject the call, 3S to turn off;
3.3 Double-click the key ---Answer/hang up the call;
3.4.4 times of click - wake up SIRI ;
3.5 Double click the key - Play/Pause ;
3.6 Triple click on the left: Previous, Triple click on the right: Next
3.7. Reset the headset to original settings: Disconnect the phone from the headset, take out the headset from the watch, quickly double-tap and hold the headset touch area for 5 seconds.(If the headset can't paired, can restore the original factory to pairing)

4 Instructions and Precautions for the Use of the Headset Function
4.1 If there is a call when the headset is in the base of the bracelet, take out the headset from the base and double-click the headset key to answer.
4.2 The Call Rejection
When there is an incoming call, the device will vibrate and display a reminder.
Long press the touch area for 3 seconds to directly reject the call, or long press the headset key for 3 seconds to reject the call.

5 Main Function Introduction
*Note: To ensure that the data is valid, please enter the real gender, height and skin color in the personal information of the APP.
5.1 Exercise Monitoring
Enter the exercise monitoring interface, it displays the current number of steps, distance and calories burned.
5.2 Sleep monitoring
Enter the sleep monitoring interface and it displays the to tal sleep time last night.
5.3 Heart Rate/Blood Pressure/Blood Oxygen Test Switch to the heart rate/blood pressure/blood oxygen test interface, the LED light on the back of the bracelet will light up, the heart rate/ blood pressure/blood oxygen test will start, and the current heart rate/blood pressure/blood oxygen value will be displayed after 1-2 minutes.

Tap the touch area to exit the current test . You can also test the heart rate/blood pressure/oxygen single item or all items at the same time through the mobile APP, synchronize the test data, set the whole point measurement of the heart rate , and turn on the heart rate alarm switch.

Blood pressure test method: Please keep your body relaxed and still during the test, make sure that the bracelet is at the same height as your heart (as shown in the picture on the right), and do not talk during the test;

The data measured by this product is only for reference and cannot be used as medical diagnosis data. It is not the same concept as the blood pressure trend and heart rate used in medical diagnosis. Please do not use it for diagnosis or treatment.

5.4 Find the Bracelet
Just click the smart search bracelet function in the mobile APP, you can easily and quickly identify the location through the vibration of the bracelet.
5.5 Alarm Clock
In the alarm setting interface of the APP, alarm can be set, and the device will remind accordingly.
5.6 Information Reminder/Push
When there is new information, the device will vibrate to remind and display the content of the message. The corresponding message displays the corresponding icon.
Note: Please turn on the reminder switch in the APP first. If you need to display the notification content, you also need to set the corresponding instant tool to display the message content.
5.7 Remote Camera
Enter the "Shake and Shake to Take Photos" interface through the APP, press the middle button or quickly shake the bracelet to take pictures on the phone.
5.8 Women's Health

6 Matters Needing Attention
(1)It is forbidden to use adapters with charging voltage>5V and charging current>2A.
(2)It is forbidden to charge in the presence of water stains.
(3)This product supports waterproofing.
(4)This product is an electronic monitoring product, not as a medical reference, the data is for reference only;
(5)Wearing earphones during strenuous exercise may fall off during exercise and cause damage or loss of the product.
(6)The photoelectric sensor is a highly sensitive component, so be, you should be so careful to prevent it being hit by hard objects. Perspiration and dust may adhere to the surface after wearing it for a period of time and you can use a soft cloth to clean it regularly.
(7)In order to ensure driving safety, please do not make calls while driving. If you need to use X17_mini to answer calls, please be sure to remove the earphones from the base of the bracelet before driving and put on them. Do not do this operation while driving.
(8)To use the headset function in the car, please ignore the connection with the car Bluetooth in the Bluetooth settings of the mobile phone.
(9)If the earphone charging is not good, maybe dirty or water stains on the earphone charging point. Please wipe the charging point dry with a dry cotton swab.

7 Common Problems
Q1: Why is the heart rate (sleep) test inaccurate?
A1: First of all, the bracelet device monitors human activities through electronic sensors. It is normal for consumer-grade products to have certain errors. Please treat the data objectively.

Q2: Where can I set the APP permissions?
A2: Android phones-Settings-Authority management-find the "FitCloudPro" application-set to trust this software.
(1)If the mobile phone is installed with security management or cleaning acceleration applications, please set "FitCloudPro " as the daily list (trust list);
(2)In the authorization management program of the mobile phone system, please set "FitCloudPro" as a trusted application, functions such as caller ID need to obtain auth orization to realize the function.

Q3: Call incoming： there is a reminder on the device, but no sound can be heard in the headset after connecting?
A3: There will be a delay on the Bluetooth headset when there is an incoming call, you can answer it after a few rings. If the call is connected through a mobile phone, please check whether the voice channel is a mobile phone or a headset on the mobile phone. If the mobile phone is switched to a headset, the default is to follow the princip le of which device is connected to and answered on which device.

Q4: I am wearing headphones, but I cannot hear the ringtone when I call?
A4: Please make sure that the headset and the phone are within the effective Bluetooth connection distance. If the phone has been connected to many Bluetooth devices, please clear the invalid connection in the phone's Bluetooth settings.

8 Basic Parameters
Main control chip: RTL8762D
Body weight: 57g
Bluetooth version: Bluetooth 5.0,Bluetooth 4.0
Battery type: polymer lithium battery
Battery capacity: Charging Module 205mAh ;Headset 25mAh .
Charging voltage: 5V
Charging current: 150mA
Working temperature: -5~45 C

Equipment requirements:
Android 4.4 and above system phones, and support Bluetooth 4.0 and above Android phones. IOS 8.0 and above system, iPhone 4S and above iPhone.

This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis,medical research, diagnostic, or treatment purposes.

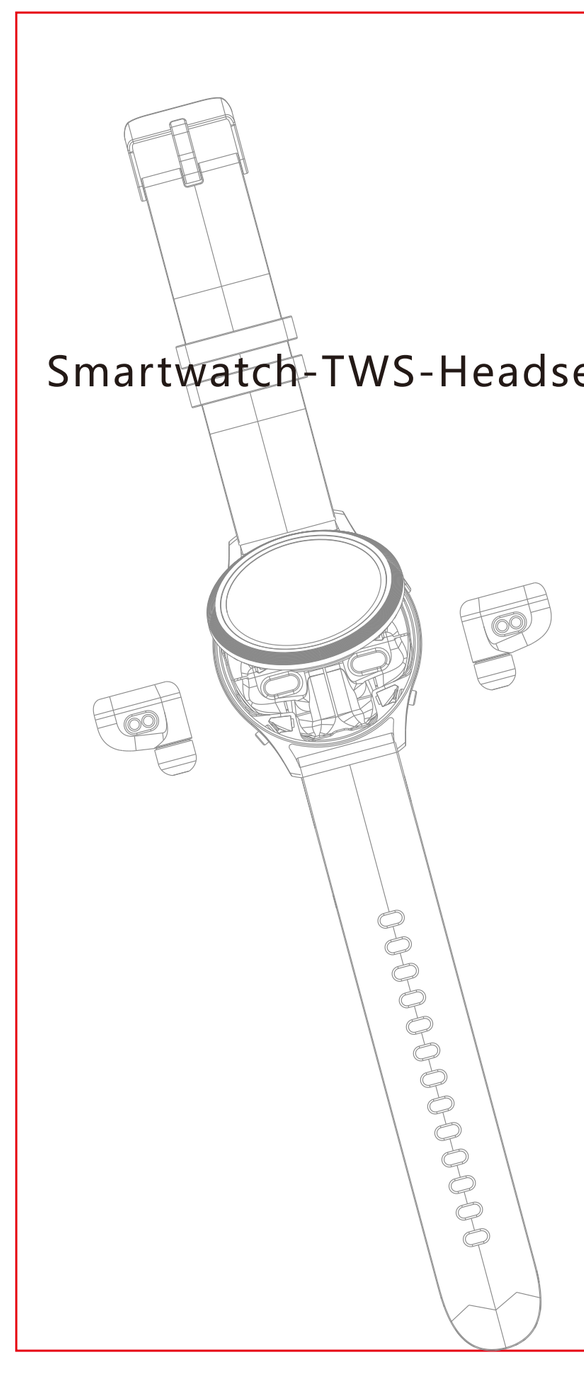

Smartwatch-TWS-Headset

Informationen für den Benutzer

【1】Für relevante elektronische Geräte oder Peripheriegeräte enthalten die Anweisungen, die den Benutzern zur Verfügung gestellt werden, folgende oder ähnliche Anweisungen:

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

-Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verschieben.

-Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einer anderen Schaltung an als die, an die der Empfänger angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

【2】Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurden, können die Gerätebetriebsberechtigungen des Benutzers ungültig machen. Der Beispielinhalt ist wie folgt:

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu bedienen, aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät und seine Antennen dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeine HF-Expositionsanforderung zu erfüllen. Das Gerät kann in tragbaren Belichtungszustand ohne Einschränkung verwendet werden.

1 Aufbau

1.1 übersicht

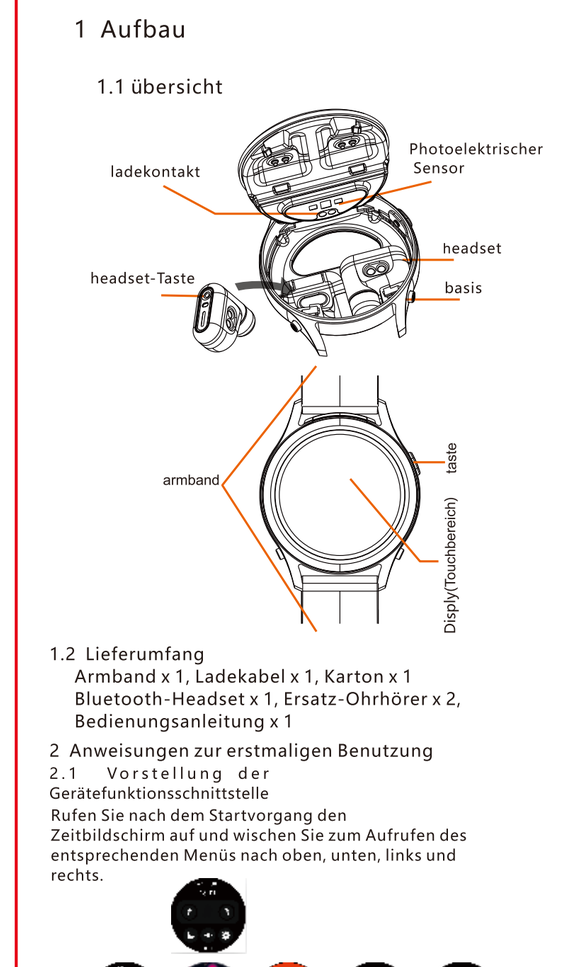

1.2 Lieferumfang
Armband x 1, Ladekabel x 1, Karton x 1
Bluetooth-Headset x 1, Ersatz-Ohrhörer x 2,
Bedienungsanleitung x 1

2 Anweisungen zur erstmaligen Benutzung
2.1 Vorstellung der Gerätefunktionsschnittstelle
Rufen Sie nach dem Startvorgang den Zeitbildschirm auf und wischen Sie zum Aufrufen des entsprechenden Menüs nach oben, unten, links und rechts.

2.2 Drücken Sie am Hauptbildschirm zum Aufrufen des Untermenüs die Taste.Es sind drei Stile verfügbar.

2.3 App herunterladen und installieren:
An Android-Telefonen können Sie den QR-Code scannen oder im Google Play nach „FitCloudPro " suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
An Apple-Telefonen können Sie den QR-Code scannen oder im App Store nach „FitCloudPro " suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

2.4 Bluetooth-Verbindung zwischen Armband und Headset herstellen (duale Bluetooth- Verbindung, Headset/Armband müssen einmal verbunden werden).
(1)Headset-Bluetooth-Verbindung herstellen.
a. Bluetooth am Armband einschalten: Nehmen Sie das Headset aus dem Armband und die Bluetooth-Funktion des Armbands schaltet sich automatisch ein.
b. Schalten Sie als Nächstes das Telefon ein, rufen Sie die Einstellungen auf, aktivieren Sie Bluetooth und die Bluetooth-Funktion des Telefons sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung. Suchen Sie in der Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte nach dem Eintrag „X-Audio-i ". Durch Antippen koppelt sich das Telefon mit dem Armband, um die Headset-Bluetooth-Verbindung herzustellen.

(2) ?ffnen Sie die Mobil-App „FitCloudPro ", suchen Sie am „Gerät "-Bildschirm unter „Gerät hinzufügen " nach dem Gerätemodell „X17_mini " und tippen Sie den Eintrag an, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird das Gerätemodell „X17_mini (verbunden) " unter „Gerät " in der App angezeigt.

2.4 Hinweise zur Verbindung und Kopplung
(1) Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist;
(2) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Schalten Sie es ein oder laden Sie es vor der Benutzung auf;
(3) Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei Kopplung und Verbindung maximal 50 cm vom Mobiltelefon entfernt ist;
(4) Wenn das Gerät in der App nicht gefunden werden kann, prüfen Sie in den Berechtigungseinstellungen am Mobiltelefon, ob „FitCloudPro " Bluetooth nutzen darf;
(5) Achten Sie bei der Kopplung des Headsets darauf, dass das Headset aus der Basis des Armbands entfernt wurde;
(6) Wenn das Armband oder das Mobiltelefon in der Zwischenzeit mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt wurden, müssen Sie sie erneut verbinden;
(7) Wenn bei der Verbindung der App mit dem Armband mehrere X17_mini-Armbänder im Raum sind, sollten Sie darauf achten, ob die Bluetooth-ID-Adresse mit dem Armband übereinstimmt.aufheben.

3 Funktionen der Ohrhörer-Touchtaste
3.1. Bei 4-maliger Betätigung vor der Kopplung - zwischen Chinesisch und Englisch umschalten;
3.2. Zum Einschalten 2 s drücken, zum Ablehnen eines Anrufs 1,5 s drücken, zum Abschalten 3 s drücken;
3.3. Zweimal drücken - Anruf annehmen/auflegen;
3.4. 4-mal drücken - Siri aktivieren;
3.5. Zweimal drücken - Wiedergabe/Pause;
3.6. 3-mal links drücken: Vorheriger Titel; dreimal rechts drücken: Nächster Titel

3.7. Headset auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Trennen Sie das Telefon vom Headset, nehmen Sie das Headset aus der Uhr, tippen Sie zweimal schnell auf den Headset-Touchbereich und halten Sie ihn 5 Sekunden lang angetippt. (Wenn sich das Headset nicht koppeln kann, können Sie es zur Kopplung auf den Werkszustand zurücksetzen.)

4 Anweisungen und Sicherheitshinweise zur Benutzung der Headset-Funktion
4.1 Wenn ein Anruf eingeht, während sich das Headset in der Basis des Armbands befindet, nehmen Sie das Headset aus der Basis und drücken Sie zum Annehmen zweimal die Headset-Taste.
4.2 Anruf ablehnen
Wenn ein Anruf eingeht, vibriert das Gerät und zeigt einen Hinweis. Tippen Sie 3 Sekunden lang auf den Touchbereich, um den Anruf direkt abzulehnen, oder drücken Sie zum Ablehnen des Anrufs 3 Sekunden lang die Headset-Taste.

5 Vorstellung der wesentlichen Funktionen
*Hinweis: Zur Gewährleistung der Gültigkeit der Daten geben Sie Geschlecht, Körpergröße und Hautfarbe in den ersönlichen Daten der App bitte wahrheitsgemäß an.
5.1 Trainingsüberwachung
Rufen Sie den Bildschirm der Trainingsüberwachung auf. Er zeigt die aktuelle Anzahl Schritte, die zurückgelegte Strecke und die verbrannten Kalorien.
5.2 Schlafüberwachung
Rufen Sie den Bildschirm der Schlafüberwachung auf. Er zeigt die gesamte Schlafzeit der vergangenen Nacht an.
5.3 Beim Aufrufen des Bildschirms zum Testen von Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff leuchtet die LED an der Rückseite des Armbands auf. Der Test von Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff startet und die aktuellen Daten zu Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff werden nach 1 bis 2 Minuten angezeigt.
Tippen Sie zum Verlassen des aktuellen Tests auf den Touchbereich. Auch über die Mobil-App können Sie Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff einzeln oder gemeinsam testen, die Testdaten synchronisieren, die Vollpunktmessung der Herzfrequenz einstellen und den Herzfrequenz-Alarm einschalten.

Blutdruck-Testmethode: Halten Sie Ihren Körper während des Tests ruhig und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Armband auf Höhe Ihres Herzens befindet (wie im Bild auf der rechten Seite angezeigt). Sprechen Sie während des Tests nicht;

Die von diesem Produkt gemessenen Daten dienen nur der Referenz und eignen sich nicht als medizinische Diagnosedaten. Es entspricht nicht dem in der medizinischen Diagnose verwendeten Verfahren zur Ermittlung von Blutdrucktrend und Herzfrequenz. Verwenden Sie es nicht zu Diagnose- oder Behandlungszwecken.
5.4 Armband finden
Tippen Sie einfach auf die intelligente Armbandsuchfunktion in der Mobil-App und Sie können den Standort durch Vibration des Armbands schnell und einfach ausfindig machen.
5.5 Alarm einstellen
Am Alarm-Bildschirm der App, können Sie den Alarm einstellen und das Gerät alarmiert Sie entsprechend.
5.6 Informationserinnerung/Push-Benachrichtigung
Wenn neue Informationen vorliegen, vibriert das Gerät zur Erinnerung und zeigt den Inhalt der Meldung. Die jeweilige Meldung zeigt das entsprechende Symbol.
Hinweis: Schalten Sie zunächst den Erinnerungsschalter in der App ein. Wenn Sie den Inhalt der Benachrichtigung anzeigen möchten, müssen Sie auch das entsprechende Instant-Tool zur Anzeige des Nachrichteninhalts einrichten.
5.7 Kamerafernsteuerung
Rufen Sie den Bildschirm „Zum Fotografieren schütteln " über die App auf und drücken Sie die mittlere Taste oder schütteln Sie das Armband schnell, um Fotos am Telefon zu machen.
5.7 Frauengesundheit

6 Unbedingt beachten
(1)Es dürfen keine Netzteile mit einer Ladespannung von mehr als 5 V und einem Ladestrom von mehr als 2 A verwendet werden.
(2)Das Gerät darf nicht aufgeladen werden, wenn es feucht oder nass ist.
(3)Das Produkt ist wasserdicht.
(4)Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt, kein Medizingerät. Die Daten dienen nur als Referenz;
(5)Wenn Sie bei anstrengendem Training Ohrhörer tragen, könnten diese während des Trainings herausfallen und beschädigt werden oder verlorengehen.
(6)Der photoelektrische Sensor ist eine hochempfindliche Komponente. Achten Sie darauf, ihn nicht gegen harte Gegenstände zu schlagen. Bei längerem Tragen können Schweiß und Staub daran haften. Wischen Sie ihn regelmäßig mit einem weichen Tuch sauber.
(7)Zur Gewährleistung der Fahrsicherheit sollten Sie während des Fahrens nicht telefonieren.Wenn Sie einen Anruf mit der X17_mini annehmen müssen, achten Sie darauf, vor Antritt der Fahrt die Ohrhörer aus der Basis des Armbands zu nehmen und in die Ohren zu stecken. Führen Sie diesen Schritt nicht während der Fahrt aus.

(8) Zur Nutzung der Headset-Funktion im Fahrzeug ignorieren Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons bitte die Verbindung mit der Bluetooth-Funktion des Fahrzeugs.
(9)Wenn die Ohrhörer nicht richtig geladen werden, könnten sich Schmutz- oder Wasserflecken am Ladekontakt der Ohrhörer befinden. Wischen Sie den Ladekontakt mit einem trockenen Wattestäbchen ab.tecken. Führen Sie diesen Schritt nicht während der Fahrt aus.

7 Allgemeine Probleme
F1: Warum ist der Herzfrequenz- (Schlaf) Test ungenau?
A1: Das Armband überwacht menschliche Aktivitäten durch elektronische Sensoren. Es ist normal, dass Produkte für den privaten Hausgebrauch eine bestimmte Fehlerquote aufweisen. Behandeln Sie die Daten objektiv.
F2: Wo kann ich die App-Berechtigungen einstellen?
A2: Android-Telefone > Einstellungen > Berechtigungsverwaltung > suchen Sie nach der App „FitCloudPro " > stellen Sie ein, dass der Software vertraut werden soll.
(1) Wenn auf dem Mobiltelefon eine Sicherheitssoftware oder Anwendungen zur schnelleren Bereinigung installiert ist, setzen Sie „FitCloudPro " bitte auf die Liste vertrauenswürdiger Software;
(2) Stellen Sie „FitCloudPro " im Programm der Berechtigungsverwaltung des Mobiltelefons als vertrauenswürdige App. Funktionen, wie die Anruferkennung müssen die Genehmigung einholen, damit sie funktionieren.
F3: Wenn ein Anruf eingeht, erscheint einer Erinnerung am Gerät, aber nach Verbindung ist kein Ton über das Headset zu hören. Was kann ich tun?
A3: Am Bluetooth-Headset kommt es bei einem eingehenden Anruf zu einer Verzögerung. Sie können ihn nach mehrmaligem Klingeln annehmen. Wenn der Anruf über ein Mobiltelefon verbunden ist, prüfen Sie, ob der Sprachkanal am Mobiltelefon das Mobiltelefon oder das Headset ist. Wenn das Mobiltelefon auf ein Headset eingestellt ist, gilt standardmäßig das Prinzip, dass das Gerät, zu dem die Verbindung besteht, das Gerät ist, an dem der Anruf entgegengenommen wird.
F4: Ich trage die Ohrhörer, höre aber keinen Rufton, wenn ich telefoniere. Was kann ich tun?
A4: Stellen Sie sicher, dass sich Headset und Telefon innerhalb der effektiven Bluetooth-Reichweite befinden. Wenn das Telefon mit zahlreichen Bluetooth-Geräten verbunden wurde, entfernen Sie bitte ungültige Verbindungen aus den Bluetooth-Einstellungen des Telefons.
tecken. Führen Sie diesen Schritt nicht während der Fahrt aus.

8 Grundlegende Parameter
Hauptsteuerchip: RTL8762D
Gewicht: 57 g
Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.0
Akkutyp: Lithium-Polymer-Akku
Akkukapazität: Lademodul 205 mAh; Headset 25 mAh.
Ladespannung: 5 V
Ladestrom: 150 mA
Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C

Geräteanforderungen:
Telefone mit Android 4.4 und aktueller, Unterstützung von Bluetooth 4.0 und aktueller. iPhone 4S und aktueller mit IOS 8.0 und aktueller.

Diese App ist kein medizinisches Gerät. Daten, die während der Nutzung dieser App erhalten werden, dienen nur als Referenz und sollten nicht für klinische Diagnose, medizinische Forschung, Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

Reloj inteligente con auriculares

Información a los usuarios

[1] para los dispositivos electrónicos o periféricos relacionados, las instrucciones proporcionadas al usuario incluyen las siguientes instrucciones o similares:

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de comunicaciones de los Estados unidos, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si el dispositivo causa realmente interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se alienta a los usuarios a tratar de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- - reorientar o reposicionar la antena receptora.

- - aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.

- - conecte el dispositivo a un enchufe en un circuito diferente al circuito conectado al receptor.

- - consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

[2] los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable de la supervisión pueden invalidar los permisos de operación del dispositivo del usuario. El ejemplo es el siguiente:

Importante: los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por el fabricante responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: este dispositivo y sus antenas no deben ser compartidos ni coordinados con ninguna otra antena o transmisor.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

1 Apariencia

1.1 Introducción general

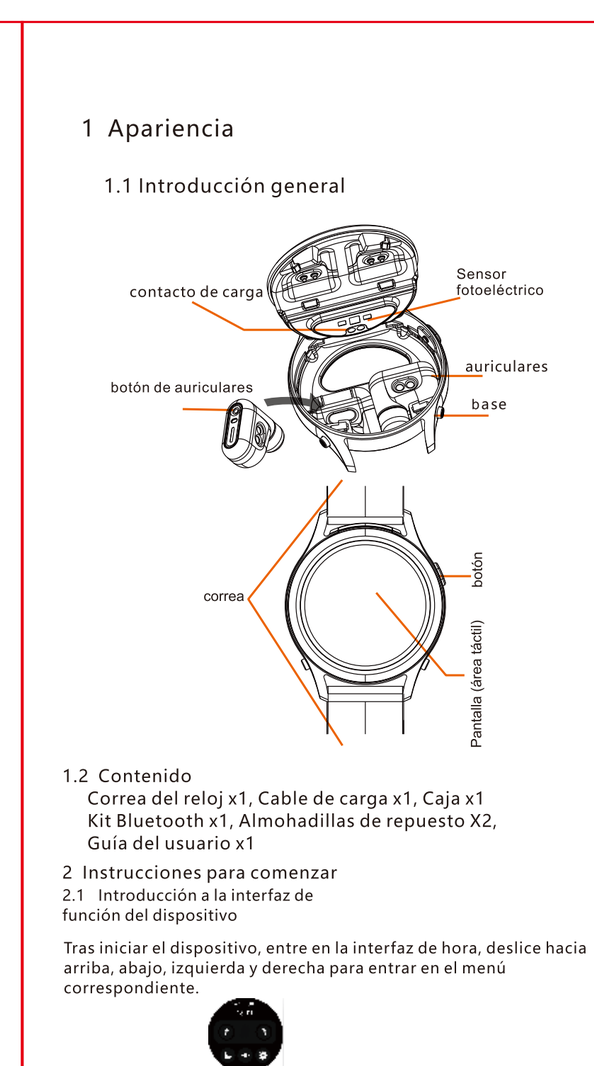

1.2 Contenido
Correa del reloj x1, Cable de carga x1, Caja x1
Kit Bluetooth x1, Almohadillas de repuesto X2,
Guía del usuario x1

2 Instrucciones para comenzar
2.1 Introducción a la interfaz de función del dispositivo
Tras iniciar el dispositivo, entre en la interfaz de hora, deslice hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para entrar en el menú correspondiente.

2.2 En el estado de la interfaz principal, pulse la tecla para entrar en el submenú, donde aparecerán tres estilos disponibles.

2.3 Descarga del software e instalación de la aplicación:
Si dispone de un teléfono Android puede escanear el código QR o buscar «FitCloudPro» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Si dispone de un teléfono Apple pueden escanear el código QR o buscar «FitCloudPro» en la App Store para descargarla e instalarla.
2.4 Conexión Bluetooth entre el reloj y los auriculares (este dispositivo cuenta con una conexión Bluetooth dual, los auriculares y el reloj se deben conectar una vez).
(1)Conexión Bluetooth de los auriculares.
a. Encienda el Bluetooth del reloj: Retire los auriculares del reloj y el Bluetooth del reloj se encenderá automáticamente.
b. A continuación, encienda el teléfono, haga clic en Configuración, active el Bluetooth y este buscará automáticamente el modelo del Bluetooth del reloj, «X-Audio-i», en los dispositivos disponibles. Posteriormente, haga clic para completar el emparejamiento Bluetooth de los auriculares.

(2)Abra la aplicación móvil «FitCloudPro», busque el modelo de dispositivo «X17_mini» en «Añadir dispositivo» en la interfaz «Dispositivo» y haga clic para conectarse. Tras haber realizado la conexión correctamente, «X17_mini (conectado)» aparecerá en «Dispositivo» dentro de la APP.

2.4 Notas sobre conexión y emparejamiento
(1) Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido;
(2) Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente batería y enciéndalo o cárguelo antes de usarlo;
(3) Asegúrese de que el dispositivo esté a menos de 50 cm del teléfono móvil al realizar el emparejamiento y conectarlo;
(4) Si no encuentra el dispositivo en la APP, en la configuración de permisos del teléfono móvil, permita que «FitCloudPro» utilice el Bluetooth;
(5) Al emparejar los auriculares, asegúrese de retirarlos de la base del reloj;
(6) Si el reloj o el teléfono móvil se han emparejado con otros dispositivos Bluetooth anteriormente, deberá volver a conectarlos;
(7)Si hay varios relojes X17_mini, cuando la aplicación esté conectada al reloj, debe prestar atención a si la dirección de identificación del Bluetooth coincide con el reloj.

3 Función del botón táctil de los auriculares
3.1. Pulsar 4 veces antes del emparejamiento: cambio de chino e inglés;
3.2.Pulsar durante 2 segundos para encenderlos, 1,5 segundos para rechazar la llamada, 3 segundos para apagarlos;
3.3. Pulsar 2 veces: responder/colgar la llamada;
3.4. Pulsar 4 veces: activar SIRI;
3.5. Pulsar dos veces: reproducir/pausar;
3.6. Pulsar 3 veces a la izquierda: Anterior, Pulsar 3 veces a la derecha: Siguiente;
3.7. Restablezca los auriculares a la configuración original: Desconecte el teléfono de los auriculares, retire los auriculares del reloj, toque dos veces rápidamente y mantenga pulsada el área táctil de los auriculares durante 5 segundos. (Si los auriculares no se pueden emparejar, restaure los auriculares a los valores de fábrica y vuelva a intentarlo);
4 Instrucciones y precauciones para el uso de los auriculares
4.1 Si recibe una llamada cuando el auricular está en la base del reloj, retire los auriculares de la base y haga doble clic en el botón de auriculares para responder.
4.2 Rechazar una llamada
Cuando haya una llamada entrante, el dispositivo vibrará y mostrará un recordatorio. Pulse el área táctil durante 3 segundos para rechazar directamente la llamada, o mantenga pulsado el botón de auriculares durante 3 segundos para rechazar la llamada.
5 Introducción a la función principal
*Nota: Para garantizar que los datos sean válidos, introduzca el género, la altura y el color de piel reales en la información personal de la APP.
5.1 Monitorización del ejercicio
Ingrese a la interfaz de monitorización de ejercicio, donde se indica el número actual de pasos, la distancia y las calorías quemadas.
5.2 Monitorización del sueño
Ingrese a la interfaz de monitorización del sueño, donde se indica el tiempo total de sueño de la noche anterior.
5.3 Medición de la frecuencia cardíaca/tensión arterial/oxígeno en sangre Cambie a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca/presión arterial/oxígeno en sangre y la luz LED de la parte posterior del reloj se iluminará iniciando la medición. El valor actual de la frecuencia cardíaca/tensión arterial/oxígeno en sangre aparecerá tras 1-2 minutos. Pulse el área táctil para salir de la prueba actual. También puede medir la frecuencia cardíaca/tensión arterial/oxígeno de forma independiente o al mismo tiempo a través de la aplicación móvil, sincronizando los datos de la medición, configurando la medición de la frecuencia cardíaca y encendiendo el interruptor de alarma de frecuencia cardíaca.

Método de medición de la tensión arterial: Relájese y no se mueva durante la medición, asegúrese de que el reloj esté a la misma altura que su corazón (tal y como se muestra en la imagen de la derecha) y no hable durante la medición;

Los datos medidos por este producto son solo de referencia y no se deben utilizarse como datos de diagnóstico médico. Se trata de una medición de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca diferentes a los utilizados en el diagnóstico médico. No lo utilice como método de diagnóstico o tratamiento.
5.4 Encontrar el reloj
Simplemente haga clic en la función de búsqueda inteligente del reloj en la aplicación móvil para conocer fácil y rápidamente la ubicación del reloj mediante la vibración del mismo.
5.5 Alarma del reloj
En la interfaz de configuración de alarma de la APP, se puede configurar la alarma y el dispositivo mostrará dicha alarma correspondientemente.
5.6 Recordatorio/Notificaciones
Cuando haya nueva información, el dispositivo vibrará y le recordará el contenido del mensaje. El mensaje se mostrará en la pantalla con el icono correspondiente.
Nota: Primero encienda el interruptor de recordatorio en la APP. Si desea ver el contenido de la notificación, deberá configurar la herramienta instantánea correspondiente para mostrar el contenido del mensaje.
5.7 Cámara remota
Entre en la interfaz «Agitar para hacer fotos» a través de la APP, pulse el botón central o agite rápidamente la pulsera para hacer fotografías en el teléfono.
5.8 Salud de la mujer

6 asuntos a los que hay que prestar atención
(1)Está prohibido utilizar adaptadores con un voltaje de carga superior a 5V y una corriente de carga superior a 2A.
(2)Está prohibido realizar una carga en caso de la existencia de marcas de agua.
(3)Este producto es impermeable.
(4) Este producto es un producto de monitorización electrónica, no se trata de un dispositivo médico, por lo que los datos son solo de referencia;
(5)Al realizar ejercicio exigente los auriculares se pueden caer, provocando daños o pérdida del producto.
(6)El sensor fotoeléctrico es un componente de alta sensibilidad, por lo que debe tener cuidado para evitar que no reciba impactos de objetos duros.
Después de utilizar el producto durante un cierto periodo de tiempo, sudor y el polvo pueden adherirse a la superficie. Puede utilizar un paño suave para limpiarlo regularmente.
(7)Para garantizar la seguridad durante la conducción, no realice llamadas mientras conduce.
ISi necesita utilizar el «X17_mini» para contestar llamadas, asegúrese de retirar los auriculares de la base del reloj antes de iniciar la conducción. No realice esta operación mientras conduce.
(8)Para utilizar la función de auriculares en el coche, ignore la conexión Bluetooth del coche en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.
(9)Si la carga de los auriculares no es aceptable, es posible que exista suciedad o marcas de agua en el punto de carga de los auriculares. Seque el punto de carga con un bastoncillo de algodón seco.

7 Problemas habituales
P1: ¿Por qué la medición de la frecuencia cardíaca (durante el sueño) no es precisa?
R1: El reloj monitoriza las diferentes actividades a través de sensores electrónicos. Es normal que los productos de consumo presenten algunos errores. Por favor, utilice los datos de forma objetiva.

P2: ¿Dónde puedo configurar los permisos de la aplicación?
R2: Teléfonos Android. Vaya a Configuración-Administración de permisos, busque la aplicación «FitCloudPro» y autorice este software.
(1)Si el teléfono móvil tiene instaladas aplicaciones de administración de seguridad o de limpieza, configure «FitCloudPro» como dispositivo diario (dispositivo de confianza);
(2) En el programa de gestión de autorizaciones del sistema del teléfono móvil, configure «FitCloudPro» como aplicación de confianza; funciones como el identificador de llamadas deben tener permiso para realizar la función.

P3: Llamada entrante: ¿hay un recordatorio en el dispositivo, pero no se escucha ningún sonido en los auriculares después de conectarlos?
R3: Se producirá un retraso en los auriculares Bluetooth cuando haya una llamada entrante; podrá contestarla tras varios tonos de llamada. Si la llamada se realiza a través de un teléfono móvil, compruebe si el canal de voz pertenece al teléfono móvil o a los auriculares en el teléfono móvil. Si el teléfono móvil cambia a los auriculares, será necesario comprobar el dispositivo que está conectado para contestar la llamada con dicho dispositivo.

P4: ¿Estoy usando auriculares, pero no escucho el tono de llamada cuando llamo?
R4: Asegúrese de que los auriculares y el teléfono se encuentren a la distancia adecuada para realizar la conexión Bluetooth. Si el teléfono se ha conectado a varios dispositivos Bluetooth, elimine las conexiones antiguas a través de la configuración Bluetooth del teléfono.

8 especificaciones básicas

Chip principal: RTL8762D
Peso: 57g
Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.0
Tipo de batería: batería de polímero de litio
Capacidad de la batería: Módulo de carga 205 mAh; auriculares 25 mAh.
Voltaje de carga: 5V
Corriente de carga: 150mA
Temperatura de funcionamiento: -5~45°C

Requisitos del equipo:
Teléfonos con sistema Android 4.4 y superiores, y compatibles con teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superiores. Sistema IOS 8.0 y superior, iPhone 4S y superior.

Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo de referencia y no deben aplicarse con fines de diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamiento.ntiguas a través de la configuración Bluetooth del teléfono.

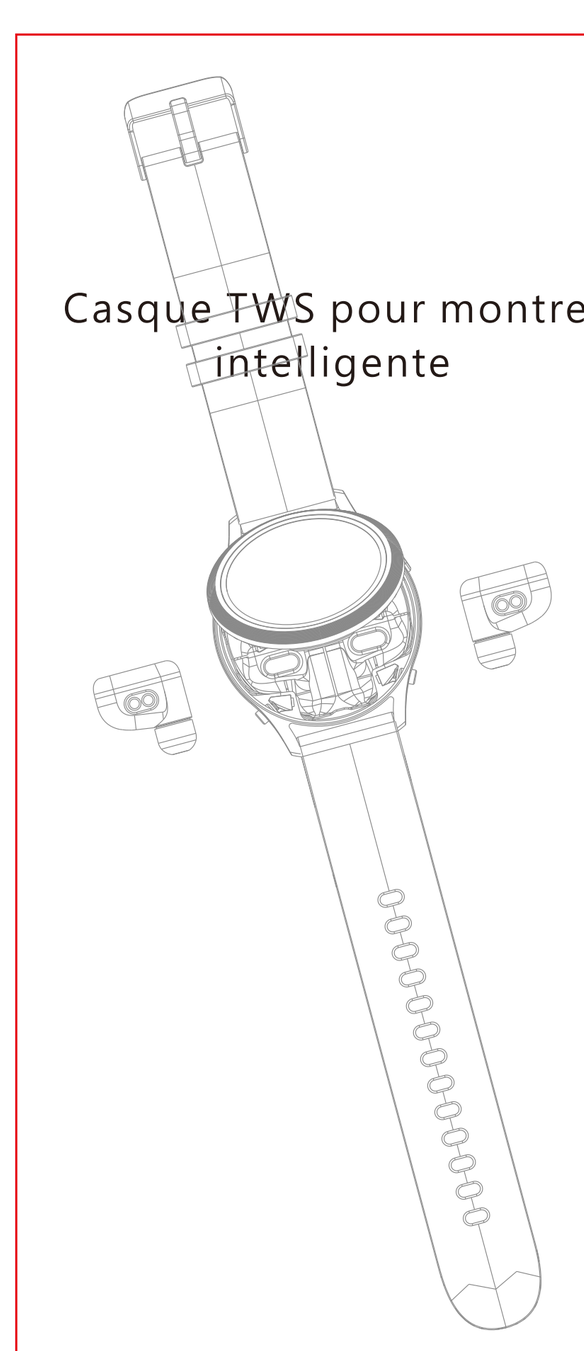

Casque TWS pour montre intelligente

Informations pour les utilisateurs

[1] pour les dispositifs électroniques ou périphériques concernés, les instructions fournies à l' utilisateur comprennent les instructions suivantes ou des instructions similaires:

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis.Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune perturbation ne se produira dans une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- - rediriger ou repositionner l'antenne de réception.

- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.

- - Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- - Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

[2] les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la réglementation peuvent invalider les autorisations de fonctionnement de l' appareil de l' utilisateur. Voici un exemple:

Important: les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil et son antenne ne doivent pas être co - installés ou fonctionner avec d'autres antennes ou émetteurs.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans aucune restriction.

1 Description de l' apparence

1.1 Introduction générale

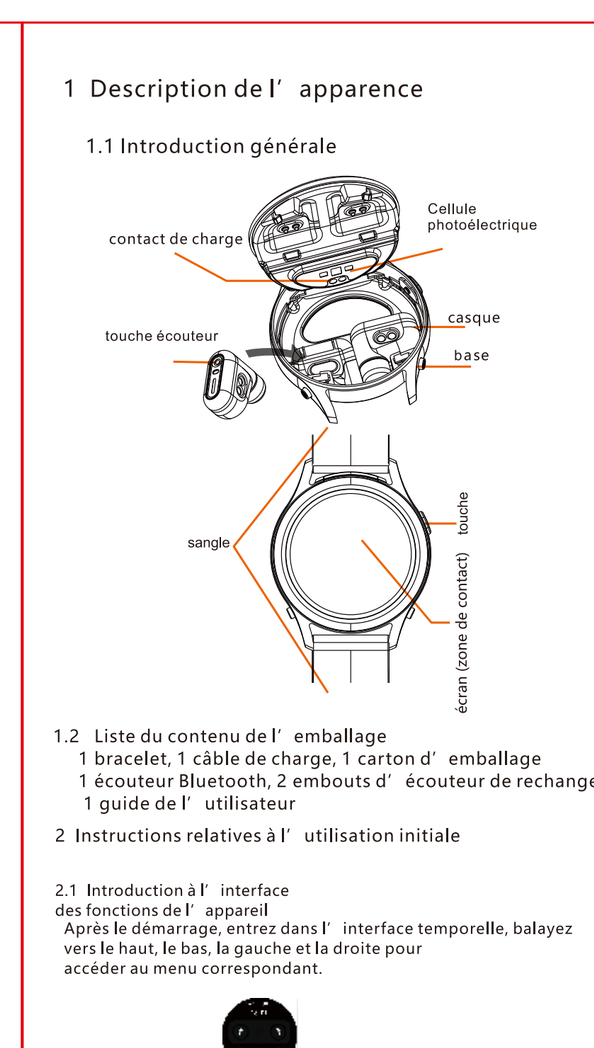

1.2 Liste du contenu de l' emballage
1 bracelet, 1 câble de charge, 1 carton d' emballage
1 écouteur Bluetooth, 2 embouts d' écouteur de rechange,
1 guide de l' utilisateur

2 Instructions relatives à l' utilisation initiale

2.1 Introduction à l' interface des fonctions de l' appareil
Après le démarrage, entrez dans l' interface temporelle, balayez vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour accéder au menu correspondant.

2.2 Dans l' interface principale, appuyez sur la touche pour accéder au sous-menu ; trois styles sont disponibles.

2.3 Téléchargement du logiciel, installation de l' application :
Les téléphones Android peuvent scanner le code QR ou rechercher « FitCloudPro » sur le marché des applications pour le télécharger et l' installer.
Les téléphones Apple peuvent scanner le code QR ou rechercher « FitCloudPro » sur l' App Store pour le télécharger et l' installer.
2.4 Connexion Bluetooth entre le bracelet et le casque (cet appareil est doté d' une double connexion Bluetooth, le casque et le bracelet doivent être connectés l' un à l' autre).
(1)La procédure de connexion Bluetooth du casque est la suivante.
a. Activez le Bluetooth du bracelet : Retirez le casque du bracelet pour activer automatiquement le Bluetooth du bracelet.

2b. Ensuite, allumez le téléphone, cliquez sur Paramètres et activez le Bluetooth. Le Bluetooth du téléphone recherchera automatiquement le numéro Bluetooth du bracelet. Trouvez le numéro Bluetooth « X-Audio-i » du bracelet dans les périphériques disponibles ci-dessous et cliquez sur l' appairage pour terminer la connexion Bluetooth du casque.
(2)Ouvrez l' application mobile « FitCloudPro », recherchez le modèle d' appareil « X17_mini » dans « Ajouter un appareil » sous l' interface « Appareil », puis cliquez pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, le modèle d' appareil « X17_mini (connecté) » s' affichera sous « Appareil » dans l' application.

2.4 Remarques sur la connexion et l' appairage
(1) Assurez-vous que la fonction Bluetooth du téléphone portable est activée ;
(2) Assurez-vous que l' appareil est suffisamment alimenté et allumez-le ou chargez-le avant de l' utiliser ;
(3) Assurez-vous que l' appareil se trouve à moins de 50 cm du téléphone mobile lors de l' appairage et de la connexion ;
(4) Si l' appareil ne peut pas être trouvé dans l' application, vérifiez dans les paramètres d' autorisation du téléphone portable si vous autorisez « FitCloudPro » à utiliser la fonction Bluetooth ;
(5)Lors de l' appairage du casque, assurez-vous que le casque est retiré de la base du bracelet ;
(6) Si le bracelet ou le téléphone portable a été apparié avec d' autres appareils Bluetooth pendant cette période, vous devez vous reconnecter ;
(7) Si plusieurs bracelets X17_mini existent, lorsque l' application est connectée au bracelet, vous devez veiller à ce que l' adresse de l' ID du Bluetooth soit cohérente avec le bracelet.
3 Fonction du bouton tactile de l' écouteur
3.1. 4 clics avant l' appairage - commutation en chinois et en anglais ;
3.2. Appui pendant 2 s pour allumer, 1,5 s pour rejeter l' appel, 3 s pour éteindre ;
3.3. Double clic sur la touche --- répondre/raccrocher l' appel ;
3.4. 4 clics - activer SIRI ;
3.5. Double clic sur la touche - Lecture/pause ;
3.6. Triple clic sur la gauche : Précédent, triple clic sur la droite : Suivant;
3.7. Réinitialisation du casque aux paramètres d' origine : Déconnectez le téléphone du casque, retirez le casque de la montre, double-cliquez rapidement sur la zone tactile du casque et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. (Si le casque ne peut pas être apparié, il est possible de rétablir l' appairage d' origine)
4 Instructions et précautions relatives à l' utilisation de la fonction casque
4.1 Si vous recevez un appel alors que le casque se trouve dans la base du bracelet, retirez le casque de la base et double-cliquez sur la touche casque pour répondre.
4.2 Rejet d' appel
En cas d' appel entrant, l' appareil vibre et affiche un rappel. Appuyez longuement sur la zone tactile pendant 3 secondes pour rejeter directement l' appel, ou appuyez longuement sur la touche casque pendant 3 secondes pour rejeter l' appel.
5 Présentation de la fonction principale
*Remarque : Pour garantir la validité des données, veuillez saisir le sexe, la taille et la couleur de peau réels dans les informations personnelles de l' application.
5.1 Surveillance des exercices
Entrez dans l' interface de suivi des exercices ; elle affiche le nombre actuel de pas, la distance et les calories brûlées.
5.2 Surveillance du sommeil
Entrez dans l' interface de surveillance du sommeil et affichez le temps de sommeil de la nuit dernière.
5.3 est de fréquence cardiaque/pression artérielle/oxygène sanguin Passez à l' interface de test de fréquence cardiaque/pression artérielle/oxygène sanguin, le voyant DEL au dos du bracelet s' allume, le test de fréquence cardiaque/pression artérielle/oxygène sanguin démarre et la valeur actuelle de la fréquence cardiaque/pression artérielle/oxygène sanguin s' affiche au bout de 1 à 2 minutes. Touchez la zone tactile pour quitter le test en cours. Vous pouvez également tester la fréquence cardiaque/la pression artérielle/l' oxygène sur un seul élément ou sur tous les éléments en même temps via l' application mobile, synchroniser les données de test, définir la mesure ponctuelle de la fréquence cardiaque et activer l' alarme de fréquence cardiaque.

Méthode de test de la pression artérielle : Veuillez garder votre corps détendu et immobile pendant le test, assurez-vous que le bracelet est à la même hauteur que votre cœur (comme indiqué sur l' image de droite), et ne parlez pas pendant le test ;

(4) Si l' appareil ne peut pas être trouvé dans l' application, vérifiez dans les paramètres d' autorisation du téléphone portable si vous automarre et la valeur actuelle de la fréquence cardiaque/pression artérielle/oxygène sanguin s' affiche au bout de 1 à 2 minutes. Touchez la zone tactile pour quitter le test en cours. Vous pouvez également tester la fréquence cardiaque/la pression artérielle/l' oxygène sur un seul élément ou sur tous les éléments en même temps via l' application mobile, synchroniser les données de test, définir la mesure ponctuelle de la fréquence cardiaque et activer l' alarme de fréquence cardiaque.
Les données mesurées par ce produit sont uniquement à titre de référence et ne peuvent pas être utilisées comme données de diagnostic médical. Il ne s' agit pas du même concept utilisé pour la pression artérielle et la fréquence cardiaque dans le cadre d' un diagnostic médical. Ne l' utilisez pas à des fins de diagnostic ou de traitement.
5.4 Recherche du bracelet
Cliquez simplement sur la fonction de recherche intelligente du bracelet dans l' application mobile, vous pouvez facilement et rapidement identifier l' emplacement grâce à la vibration du bracelet.
5.5 Réveil
Dans l' interface de réglage de l' alarme de l' appareil, l' alarme peut être réglée, et l' appareil effectuera un rappel en conséquence.
5.6 Rappel/push d' information
Lorsque de nouvelles informations sont disponibles, l' appareil vibre pour l' indiquer et il affiche le contenu du message. Le message correspondant affiche l' icône correspondante.
Remarque : Veuillez d' abord activer le commutateur de rappel dans l' application. Si vous avez besoin d' afficher le contenu de la notification, vous devez également régler l' outil instantané correspondant pour afficher le contenu du message.
5.7 Caméra distante
Entrez dans l' interface « Secouer et agiter pour prendre des photos » via l' application, appuyez sur le bouton central ou agitez rapidement le bracelet pour prendre des photos sur le téléphone.
5.8 Santé feminine

6 Points nécessitant une attention particulière
(1)Il est interdit d' utiliser des adaptateurs avec une tension de charge supérieure à 5 V et un courant de charge supérieur à 2 A.
(2)Il est interdit d' effectuer la charge en présence de taches d' eau.
(3)Ce produit est étanche à l' eau.
(4)Ce produit est un appareil de surveillance électronique, il ne s' agit pas d' une référence médicale, les données sont fournies à titre indicatif uniquement ;
(5)Le port des écouteurs pendant un exercice physique intense peut causer leur chute et entraîner des dommages ou la perte du produit.
(6)Le capteur photoélectrique est un composant très sensible, par conséquent, vous devez veiller à ce qu' il ne soit pas heurté par des objets durs. La sueur et la poussière peuvent s' incruster sur la surface après un certain temps de port, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour le nettoyer régulièrement.
(7)Afin de garantir la sécurité de la conduite, veuillez ne pas téléphoner en conduisant.
Si vous devez utiliser X17_mini pour répondre à des appels, veillez à retirer les écouteurs de la base du bracelet avant de conduire et portez-les. N' effectuez pas cette opération en conduisant.

(8)Pour utiliser la fonction casque dans la voiture, veuillez ignorer la connexion avec le Bluetooth de la voiture dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable.
(9)Si la charge des écouteurs n' est pas bonne, il se peut que le point de charge des écouteurs soit sale ou taché d' eau. Essuyez le point de charge à l' aide d' un coton-tige sec.
7 Problèmes courants

Q1 : Pourquoi le test de fréquence cardiaque (sommeil) est-il imprécis ?
R1 : Tout d' abord, le bracelet surveille les activités humaines à l' aide de capteurs électroniques. Il est normal que les produits grand public présentent certaines erreurs. Veuillez traiter les données de manière objective.
Q2 : Où puis-je régler les autorisations de l' application ?
R2 : Téléphones Android-Paramètres-Gestion des autorisations-Trouver l' application « FitCloudPro »-Régler pour faire confiance à ce logiciel.
(1)Si le téléphone portable est installé avec des applications de gestion de la sécurité ou d' accélération du nettoyage, veuillez définir « FitCloudPro » comme liste quotidienne (liste de confiance) ;
(2)Dans le programme de gestion des autorisations du système de téléphone portable, veuillez définir « FitCloudPro » comme application de confiance, les fonctions telles que l' identification de l' appelant doivent obtenir une autorisation pour réaliser la fonction.

Q3 : Appel entrant : un rappel est affiché sur l' appareil, mais aucun son ne peut être entendu dans le casque après la connexion ?
R3 : Le casque Bluetooth réagit à un appel entrant avec un certain délai. Vous pouvez répondre à l' appel après quelques sonneries. Si l' appel est connecté via un téléphone portable, veuillez vérifier sur ce dernier si le canal vocal est un téléphone portable ou un casque. Si le téléphone portable est remplacé par un casque, le principe par défaut est de suivre le principe de l' appareil auquel il est connecté et de répondre sur l' appareil en question.
Q4 : Je porte des écouteurs, mais je n' entends pas la sonnerie lorsque j' appelle ?
R4 : Assurez-vous que le casque et le téléphone se trouvent dans la distance de connexion Bluetooth appropriée. Si le téléphone a été connecté à de nombreux appareils Bluetooth, effacez la connexion non valide dans les paramètres Bluetooth du téléphone.

8 Paramètres de base

Puce de commande principale : RTL8762D
Poids du boîtier : 57 g
Version Bluetooth : Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.0
Type de batterie : batterie au lithium polymère
Capacité de la batterie : Module de charge 205 mAh ; casque 25 mAh.
Tension de charge : 5 V
Courant de charge : 150 mA
Température de fonctionnement : -5 ~ 45 °C

Exigences relatives à l' équipement :
Téléphones Android 4.4 et versions supérieures, et prise en charge des téléphones Android avec Bluetooth 4.0 et versions supérieures. Système IOS 8.0 et supérieur, iPhone 4S et supérieur.

Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l' utilisation de cette application sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.

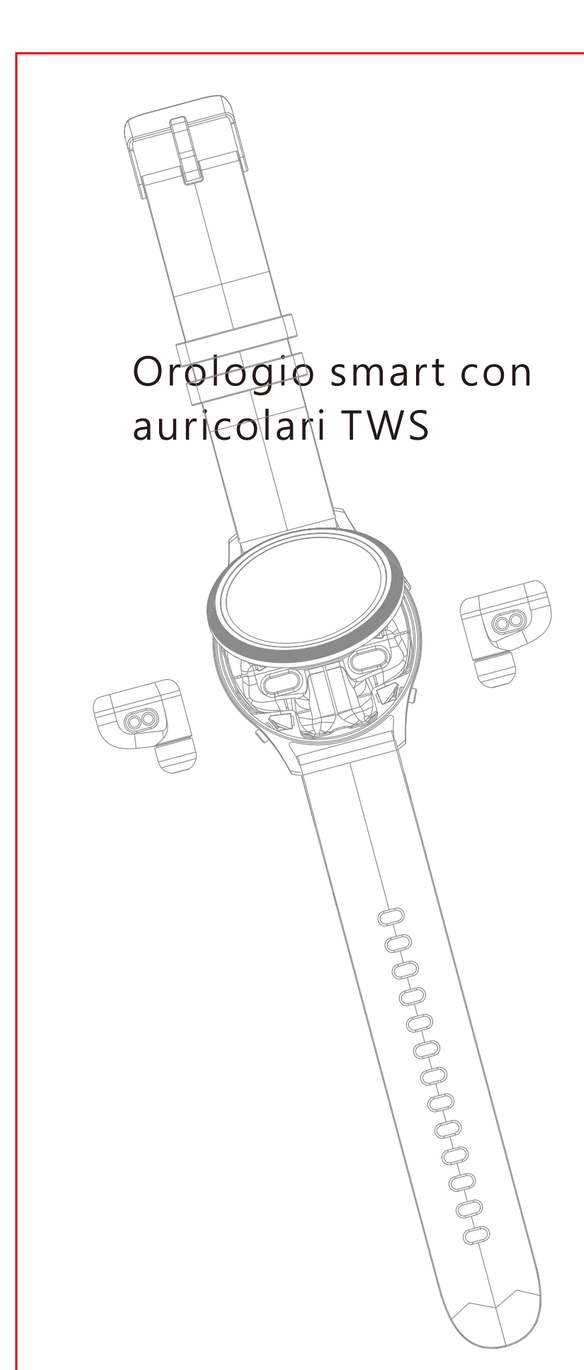

Orologio smart con auricolari TWS

Informazioni all'utente

【1】Per i dispositivi elettronici o periferiche pertinenti, le istruzioni fornite agli utenti includono le seguenti o simili istruzioni:

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle Regole FCC.Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

-Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per aiuto.

【2】Modifiche o modifiche che non sono esplicitamente approvate dalla parte responsabile della regolamentazione possono invalidare le autorizzazioni di funzionamento del dispositivo dell'utente. Il contenuto di esempio è il seguente:

Importante: modifiche o modifiche non espressamente approvate dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere collocate o funzionanti insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

1 Descrizione del prodotto

1.1 Introduzione generale

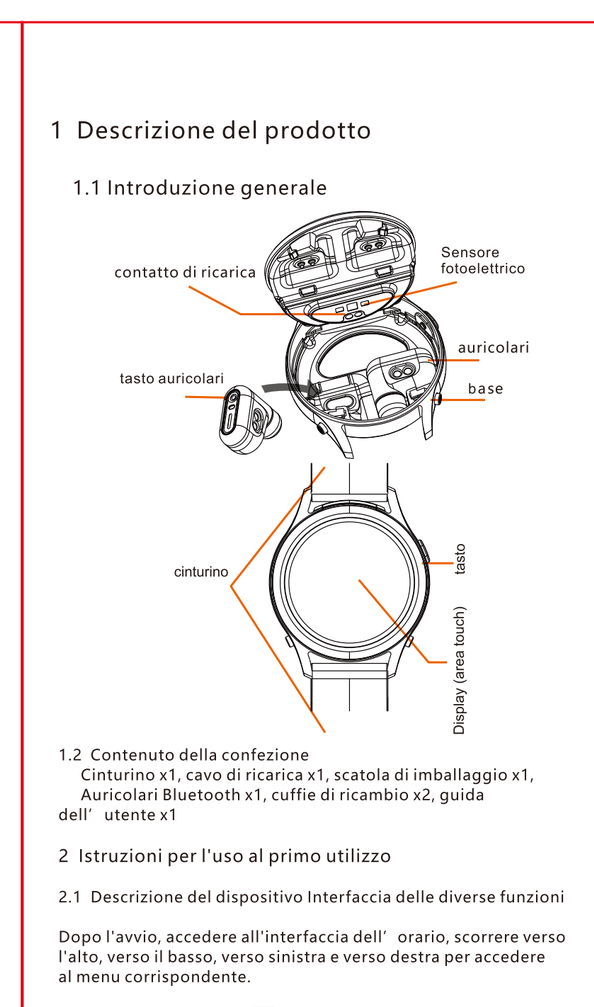

1.2 Contenuto della confezione
Cinturino x1, cavo di ricarica x1, scatola di imballaggio x1, Auricolari Bluetooth x1, cuffie di ricambio x2, guida dell' utente x1

2 Istruzioni per l'uso al primo utilizzo

2.1 Descrizione del dispositivo Interfaccia delle diverse funzioni
Dopo l'avvio, accedere all'interfaccia dell' orario, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra per accedere al menu corrispondente.

2.2 Nell'interfaccia, premere il tasto del dispositivo per accedere al sottomenu: sono disponibili tre stili di visualizzazione.

2.3 Scaricare il software e installare l'app:
Per i telefoni Android, è possibile scansionare il codice QR o cercare "FitCloudPro" nelle applicazioni per scaricare e installare l' app.
Per i telefoni Apple, è possibile scansionare il codice QR o cercare "FitCloudPro" nell'App Store per scaricare e installare l' app.

2.4 Connessione Bluetooth tra orologio e auricolare (questo dispositivo si basa su una doppia connessione Bluetooth, pertanto auricolare e orologio devono essere collegati entrambi una prima volta.)
(1)Per la connessione Bluetooth degli auricolari ,procedere nel modo seguente.
a. Attivare il Bluetooth dell' orologio: Estrarre un auricolare dall' orologio e il Bluetooth dell' orologio si attiverà automaticamente.

b. Successivamente, accendere il telefono, fare clic su Impostazioni, attivare il Bluetooth e il Bluetooth del telefono cercherà automaticamente il numero corrispondente al Bluetooth dell' orologio. Cercare il numero Bluetooth "X_Audio-i" dell' orologio tra i dispositivi disponibili di seguito riportati, e fare clic per abbinarlo e completare la connessione Bluetooth degli auricolari.

(2)Aprire l'app per dispositivo mobile "FitCloudPro", cercare il modello di dispositivo "X17_mini" alla voce "Add Device" nell'interfaccia "Device", quindi fare clic per connettersi. Una volta eseguita la connessione, il modello di dispositivo "X17_mini (connected)" verrà visualizzato alla voce "Device" nell'app.

2.4 Note sulla connessione e l'abbinamento
(1) Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia attivato;
(2) Assicurarsi che il dispositivo sia sufficientemente carico, quindi accenderlo o caricarlo prima dell'uso;
(3) Assicurarsi che il dispositivo si trovi entro una distanza di 50 cm dal telefono cellulare durante l' abbinamento e la connessione;
(4) Se non è possibile trovare il dispositivo nell'app, verificare nelle impostazioni di autorizzazione del telefono cellulare se occorre consentire a "FitCloudPro" di utilizzare il Bluetooth;
(5) Durante l' abbinamento degli auricolari, assicurarsi di estrarle dalla base dell' orologio;
(6) Se l' orologio o il telefono cellulare sono già stati abbinati ad altri dispositivi Bluetooth, è necessario ricollegarli;
(7) Se ci sono più orologi X17_mini, dopo avere collegato l'app all' orologio è necessario fare attenzione che l'indirizzo ID Bluetooth corrisponda all' orologio in questione.
3 Funzione del pulsante touch degli auricolari
3.1. Cliccare 4 volte prima di procedere all' abbinamento - Commutazione da cinese a inglese;
3.2.Premere per 2 secondi per accendere, premere 1,5 secondi per rifiutare una chiamata, premere 3 secondi per spegnere;
3.3. Fare doppio clic sul tasto dell' orologio --- Per rispondere/chiudere una chiamata;
3.4. Cliccare 4 volte - Attivazione SIRI;
3.5. Fare doppio clic sul tasto dell'orologio - Riproduzione/Pausa;
3.6. Cliccare tre volte a sinistra: Indietro; cliccare tre volte a destra: Successivo;
3.7. Ripristinare le impostazioni originali degli auricolari: Scollegare il telefono dagli auricolari, estrarre gli auricolari dall'orologio, toccare rapidamente due volte e tenere premuta l'area touch degli auricolari per 5 secondi. (Se non è possibile abbinare gli auricolari, ripristinare l'abbinamento originale predefinito.)
4 Istruzioni e precauzioni per l'uso degli auricolari
4.1 Se si riceve una chiamata mentre gli auricolari sono nella base dell' orologio, estrarre gli auricolari dalla base e fare doppio clic sul tasto degli auricolari per rispondere.
4.2 Rifiutare una chiamata
Quando si riceve una chiamata, il dispositivo vibra e visualizza un promemoria. Premere sull'area touch per 3 secondi per rifiutare direttamente la chiamata, oppure premere il tasto degli auricolari per 3 secondi.
5 Introduzione alle funzioni principali
*Nota: Per garantire la validità dei dati, inserire il sesso, l'altezza e il colore della pelle effettivi nelle informazioni personali richieste nell' app.
5.1 Monitoraggio dell' attività fisica
L'interfaccia di monitoraggio dell'attività fisica visualizza il numero attuale di passi, la distanza e le calorie bruciate.
5.2 Monitoraggio del sonno
Accedendo all'interfaccia di monitoraggio del sonno, viene visualizzata la durata del sonno della notte precedente.
5.3 Test della frequenza cardiaca/della pressione sanguigna/dell'ossigeno nel sangue
Passare all'interfaccia del test della frequenza cardiaca/della pressione sanguigna/dell'ossigeno nel sangue: la spia LED sul retro dell' orologio si accende, il test della frequenza cardiaca/della pressione sanguigna/dell'ossigeno nel sangue si avvia e il valore attuale della frequenza cardiaca/della pressione sanguigna/dell'ossigeno nel sangue viene visualizzato dopo 1-2 minuti. Toccare l'area touch per uscire dal test in corso. È inoltre possibile testare la frequenza cardiaca/la pressione sanguigna/l'ossigeno nel sangue per un singolo elemento o per tutti gli elementi contemporaneamente tramite l'app per dispositivo mobile, sincronizzare i dati del test, impostare la misurazione del punto della frequenza cardiaca e attivare l'interruttore di allarme della frequenza cardiaca.

Metodo per il test della pressione arteriosa: Durante il test è necessario mantenere il corpo rilassato e fermo, assicurandosi che l' orologio si trovi alla stessa altezza del cuore (come mostrato nell'immagine a destra). Inoltre, si raccomanda di non parlare durante il test;

I dati misurati con questo dispositivo hanno solo un valore di riferimento e non possono essere utilizzati come dati per fornire una diagnosi medica. Non si tratta infatti dello stesso sistema di misurazione dell'andamento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca utilizzato durante una diagnosi medica. Non utilizzare il dispositivo ai fini di una diagnosi o di un trattamento.
5.4 Come trovare l' orologio
Basta fare clic sulla funzione di ricerca intelligente dell' orologio nell'app per dispositivo mobile per identificarne facilmente e rapidamente la posizione, grazie alla vibrazione dell' orologio.
5.5 Sveglia
Nell'interfaccia di impostazione della sveglia dell'app, è possibile impostare la sveglia, che verrà memorizzata nel dispositivo.
5.6 Promemoria/Notifica push di informazione
Quando ci sono nuove informazioni, il dispositivo vibra per avvisare e visualizza il contenuto del messaggio. Per ogni messaggio viene visualizzata l' icona corrispondente.
Nota: Per prima cosa occorre attivare la funzione di promemoria nell' app. Se si desidera visualizzare il contenuto del messaggio di notifica, è necessario impostare anche la funzione istantanea corrispondente .
5.7 Fotocamera remota
Accedere all'interfaccia "Shake and Shake to Take Photos" nell'app, premere il pulsante centrale o scuotere rapidamente l' orologio per scattare foto sul telefono.
5.8 Salute donna

6 Importanti caratteristiche da ricordare
(1) È vietato utilizzare adattatori con una tensione di carica >5 V e una corrente di carica >2 A.
(2)è vietato ricaricare il dispositivo in presenza di macchie d'acqua.
(3)Questo prodotto è resistente all'acqua.
(4)Questo orologio è un prodotto di monitoraggio elettronico e non è un dispositivo medico, pertanto i dati servono solo come riferimento;
(5) Se si indossano gli auricolari durante un'attività fisica intensa, questi potrebbero cadere, danneggiarsi o andare persi.
(6)Il sensore fotoelettrico è un componente altamente sensibile, pertanto è necessario fare attenzione per evitare che venga colpito da oggetti duri. Il sudore e la polvere possono aderire alla superficie se si indossa l'orologio per un certo periodo di tempo; utilizzare un panno morbido per pulirlo regolarmente.
(7)Per garantire la propria sicurezza, non effettuare chiamate durante la guida. Se è necessario utilizzare l' orologio X17_mini per rispondere alle chiamate, assicurarsi di rimuovere gli auricolari dalla base dell' orologio e indossarli prima di mettersi alla guida. Non eseguire questa operazione durante la guida.
(8)Per utilizzare gli auricolari in auto, ignorare la connessione con il Bluetooth dell'auto nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare.

(9)Se non è possibile ricaricare gli auricolari, il punto di ricarica degli auricolari potrebbe essere sporco o bagnato. Asciugare il punto di ricarica con un cotton fioc asciutto.
7 Problemi più comuni
Q1: Perché il test della frequenza cardiaca (del sonno) è impreciso?
A1: Innanzitutto, l' orologio monitora le attività umane attraverso sensori elettronici. È normale che i prodotti di consumo presentino alcuni errori. Si raccomanda pertanto di trattare i dati in modo oggettivo.
Q2: Dove posso impostare le autorizzazioni dell'app?
A2: Telefoni Android: Impostazioni - Gestione delle autorizzazioni - Trova l'applicazione "FitCloudPro" - Impostare il software nei preferiti.
(1) Se sul telefono cellulare sono installate applicazioni di gestione della sicurezza o di accelerazione della pulizia, impostare "FitCloudPro" nell' elenco giornaliero (elenco delle impostazioni preferite);
(2)Nel programma di gestione delle autorizzazioni del sistema di telefonia mobile, impostare "FitCloudPro" come applicazione preferita. Le funzioni come l' identificazione della persona che chiama devono essere autorizzate per poter essere utilizzate.
Q3: Chiamata in arrivo: viene visualizzata una notifica sul dispositivo, ma non si sente alcun suono nelle cuffie dopo la connessione?
A3: Gli auricolari Bluetooth potrebbero avere un ritardo di funzionamento in caso di una chiamata in arrivo; in questo caso, sarà possibile rispondere dopo qualche squillo. Se la chiamata è collegata a un telefono cellulare, verificare se la risposta vocale avviene tramite il telefono cellulare o gli auricolari del telefono cellulare. Se il telefono cellulare viene collegato agli auricolari, per impostazione predefinita è preferibile rispondere con lo stesso dispositivo al quale ci si è collegati.
Q4: Perché indossando gli auricolari, non si sente la suoneria durante una chiamata?
A4: Assicurarsi che gli auricolari e il telefono si trovino entro la distanza effettiva di connessione Bluetooth. Se il telefono si è collegato a molti dispositivi Bluetooth, eliminare le connessioni non valide nelle impostazioni Bluetooth del telefono.

8 Parametri di base

Chip di controllo principale: RTL8762D
Peso del dispositivo: 57 g
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.0
Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio
Capacità della batteria: modulo di ricarica 205 mAh; auricolari 25 mAh.
Tensione di carica: 5 V
Corrente di carica: 150 mA
Temperatura di esercizio: -5 ~ 45 °C

Requisiti dell' apparecchiatura:
telefoni con sistema Android 4.4 o versioni successive che supportano la tecnologia Bluetooth 4.0 o superiore. Sistema IOS 8.0 o superiore per iPhone 4S o versioni successive.

Questa applicazione non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'uso di questa app sono solo per riferimento e non devono essere utilizzati per scopi di diagnosi clinica, ricerca medica, diagnostica o trattamento.

スマートウォッチTWS ヘッドセット

ユーザーへのメッセージ

【1】関連する電子機器または周辺機器について、ユーザに提供される命令には、以下または同様の命令が含まれる：

注：米国連邦通信委員会規則第15部の規定によると、このデバイスはBクラスのデジタルデバイスの制限に適合するようにテストされている。
これらの制限は、住宅の設置における有害な干渉を防止するための合理的な保護を提供することを目的としています。この装置は無線周波数エネルギーを発生、使用し、放射することができ、説明に従って設置し、使用しないと、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定のインストールで干渉が起こらない保証はありません。デバイスが無線またはテレビ受信に有害な干渉を与えていることが確実である場合は、デバイスをシャットダウンしてオンにすることによって決定することができ、ユーザは、次の1つ以上の方法で干渉を修正しようと試みることを奨励する：

--受信アンテナの向きを変更するか、位置を変更します。

--デバイスと受信機の間隔を増やします。

-受信機に接続されている回路とは異なる回路上のソケットにデバイスを接続します。

--サポートを受けるには、ディーラーまたは経験のあるラジオ/テレビ技術者にお問い合わせください。

【2】規制責任者によって明示的に承認されていない変更や変更は、ユーザーのデバイス操作権限を無効にする可能性があります。次に例を示します。

重要：コンプライアンスを担当していない製造元が明示的に承認した変更や変更は、ユーザーがデバイスを操作する権限を無効にする可能性があります。

注意：この装置およびそのアンテナは、他のアンテナまたは送信機と共有または協働してはならない。

この装置は一般的な無線周波数曝露要件に適合していると評価されている。この装置は、任意の制限なしに携帯型暴露条件下で使用することができる。

1 外観の説明

1.1 概要

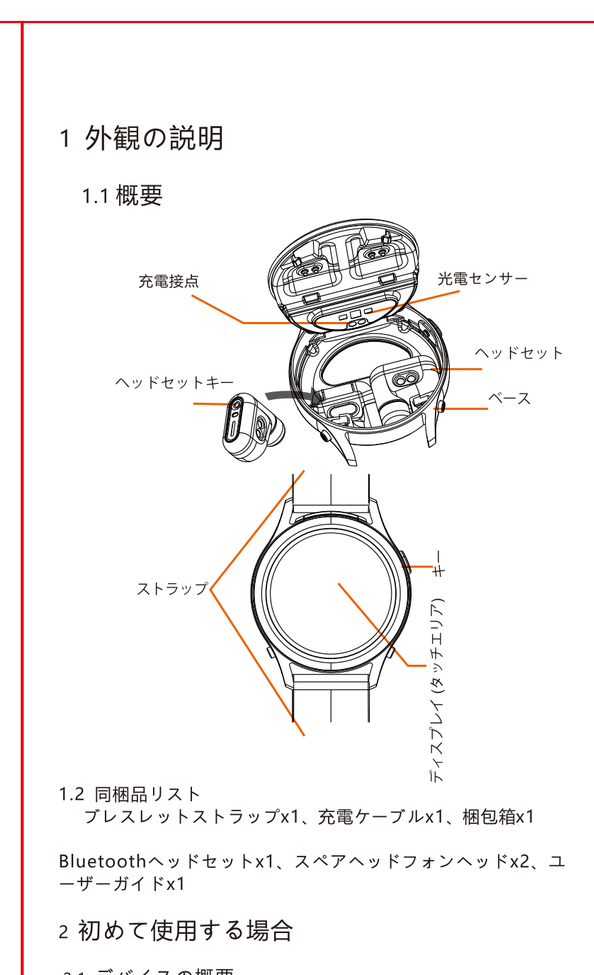

1.2 同梱品リスト
ブレスレットストラップx1、充電ケーブルx1、梱包箱x1

Bluetoothヘッドセットx1、スペアヘッドフォンヘッドx2、ユーザーガイド Fx1

2 初めて使用する場合

2.1 デバイスの概要
機能インターフェイス

起動したら、時間インターフェイスに移動し、上下/左右方向にスワイプして、該当するメニューに移動します。

2.2 メインインターフェイスで、キーを押してサブメニューに移動すると、3つのスタイルから選択できます。

2.3 ソフトウェアのダウンロード、アプリのインストール：
Androidスマートフォンでは、QRコードをスキャンするか、アプリケーションマーケットで「FitCloudPro」を検索してアプリをダウンロードし、インストールします。
Appleスマートフォンでは、QRコードをスキャンするか、アプリストアで「FitCloudPro」を検索してアプリをダウンロードし、インスト

2.4 ブレスレットとヘッドセットとのBluetooth接続 (本デバイスはデュアルBluetooth接続。ヘッドセット/ブレスレットの両方を1回ずつ接続する必要があります。)
(1)次の指示に従って、ヘッドセットをBluetoothに接続します。a. ブレスレットでBluetoothを起動します。ブレスレットからヘッドセットを取り出すと、自動的に、ブレスレットのBluetoothが起動します。

b. 次に、スマートフォンの電源を入れ、「Settings」をクリックしてBluetoothを起動します。スマートフォンのBluetoothが自動的にブレスレットのBluetooth番号を検出し、利用可能なデバイスで、ブレスレットのBluetooth番号「X_Audio-1」を検出します。それをクリックすると、Headset Bluetoothのペアリングが完了します。

(2)モバイルアプリ「FitCloudPro」を開き、「Device」インターフェイスの「Add Device」でデバイスモデル「X17_mini」を検索し、それをクリックして接続します。接続が成功すると、アプリの「Device」セクションに、デバイスモデル「X17_mini (connected)」が表示されます。

2.4 接続とペアリングに関する注意事項
(1) スマートフォンでBluetoothが起動していることを確認します。
(2) デバイスのバッテリーに十分な残量があることを確認し、十分な場合は電源を入れます。残量が少ない場合は、使用前に充電してください。
(3) ペアリングや接続の際には、本デバイスとスマートフォンの間の距離が50cm以内であることを確認してください。
(4) アプリでデバイスが見つからない場合は、スマートフォンの権限設定で、「FitCloudPro」にBluetoothの使用が許可されているかどうか、確認してください。
(5) ヘッドセットをペアリングする場合は、必ずブレスレットのベースからヘッドセットを取り外してください。
(6) ブレスレットまたはスマートフォンが、既に他のBluetoothデバイスとペアリングされていた場合は、もう一度接続し直す必要があります。
(7)X17_miniブレスレットが2台以上ある場合、アプリをブレスレットに接続する際に、Bluetooth IDアドレスがブレスレットのアドレスと一致しているか、確認してください。
3 イヤフォンのタッチボタンの機能
3.1. ペアリング前に4回クリックする - 「Chinese」と「English」が切り替わります。
3.2. 2秒間長押しするとオンになり、1.5秒間長押しすると通話が拒否され、3秒間長押しするとオフになります。
3.3. キーを2回クリックする --- 着信に応答したり、電話を切ることができます。
3.4. 4回クリックする - Siriが起動します。
3.5. キーを2回クリックする - 再生/一時停止。
3.6. 左側を3回クリックする: 前のトラックに戻る、右側を3回クリックする: 次のトラックに進む
3.7. ヘッドセットを初期設定にリセットする: ヘッドセットとスマートフォンの接続を解除して、ウォッチからヘッドセットを取り出し、ヘッドセットのタッチエリアをすばやく2回タップしてから5秒間長押しします。(ヘッドセットがペアリングできない場合は、元の工場出荷時の設定に戻します)
4 ヘッドセット機能の使用方法と注意事項
4.1 ブレスレットのベースにヘッドセットが入っているときに着信があった場合、ベースからヘッドセットを取り出し、ヘッドセットキーを2回クリックして応答します。
4.2 着信拒否
着信があると、デバイスが振動してリマインダーが表示されます。タッチエリアを3秒間長押しするか、ヘッドセットキーを3秒間長押しすると着信が拒否されます。
5 主要機能の紹介
*注意：データが有効であることを確認するために、アプリの個人情報に、性別、身長、肌の色を入力してください。
5.1 エクササイズモニタリング
エクササイズモニタリングインターフェイスに移動すると、現在の歩数、距離数、消費カロリーが表示されます。
5.2 睡眠モニタリング
睡眠モニタリングインターフェイスに移動すると、昨晩の睡眠時間の合計が表示されます。
5.3 「Heart Rate/Blood Pressure/Blood Oxygen Test」を心拍数/血圧/血中酸素テストインターフェイスに切り替えると、ブレスレット背面のLEDライトが点灯し、心拍数/血圧/血中酸素テストが開始します。1～2分経過すると、現在の心拍数/血圧/血中酸素値が表示されます。タッチエリアをタップすると、現在のテストが終了します。モバイルアプリで、心拍数/血圧/酸素のうちの1項目または全項目を同時にテストしたり、テストデータを同期したり、心拍数の全点測定を設定したり、心拍アラームスイッチを起動することもできます。

血圧テスト方法：テスト中は身体をリラックスして動かず、ブレスレットを心臓と同じ高さにし(右図参照)、話をしないでください。

本製で測定したデータは単なる参考であり、医療診断データとして使用することはできません。医療診断で使用される血圧傾向や心拍数とは同じ概念ではありません。診断や治療には使わないでください。

5.4 ブレスレットを検出する
モバイルアプリのブレスレットスマート検索機能をクリックすると、ブレスレットが振動するので、すばやく簡単に位置を見つけることができます。
5.5 目覚まし時計
アプリのアラーム設定インターフェイスでアラームを設定することができます。アラームに基づいてデバイスから通知されます。
5.6 情報リマインダー/プッシュ通知
新しい情報が来ると、デバイスが振動して通知され、そのメッセージの内容が表示されます。メッセージには、それに対応するアイコンが表示されます。
注意：まず、アプリのリマインダースイッチをオンにしてください。通知内容を表示したい場合は、対応するインスタントツールで、メッセージの内容を表示するように設定してください。
5.7 リモートカメラ
アプリで「Shake and Shake to Take Photo」インターフェイスに移動し、中央のボタンを押すか、ブレスレットを速く振ると、スマートフォンで写真が撮影されます。
5.8 女性の健康

6 注意事項
(1)充電電圧が5Vより高い、または、充電電流が2Aより大きいアダプターは使用できません。
(2)水で濡れている状態で充電しないでください。
(3)本製品は防水です。
(4)本製品は電子モニタリング機器であり、医療用ではありません。データは単なる参考です。
(5)イヤホンを装着して激しい運動をすると、運動中にイヤホンが外れて本製品が破損したり紛失する原因となります。
(6)光電センサーは非常に敏感な部品ですので、硬い物にぶつけないように注意ください。長期間着用すると、表面に汗や汚れが付着することがあるので、定期的に柔らかい布で拭いてください。
(7)安全運転のため、運転中は通話しないでください。
X17_miniを使用して着信に応答する場合は、運転前にブレスレットのベースからイヤホンを取り外し、装着してください。運転中はこの操作を行わないでください。
(8)自動車の中でヘッドセット機能を使用する場合、スマートフォンのBluetooth設定で、自動車のBluetoothとの接続を解除してください。

(9)イヤホンの充電ポイントに汚れや水濡が付着していると、イヤホンがうまく充電できないことがあります。乾いた綿棒で充電ポイントを拭き、乾燥させてください。

7 よくある問題

Q1: 心拍数 (睡眠) テストの結果が不正確なのですが、その理由は?
A1: まず、ブレスレットデバイスは、電子センサーを通じて人体の動きを監視していることにご注意ください。消費者向け製品にはある程度誤差があるのが普通です。データは単なる参考とお考えください。

Q2:アプリの権限は、どこで設定できますか?
A2: Androidスマートフォン - 設定 - 権限管理 - 「FitCloudPro」アプリと移動し、「このソフトウェアを信頼する」に設定します。
(1)スマートフォンにセキュリティ管理アプリやクリーニング加速アプリがインストールされている場合、「FitCloudPro」を、日常リスト (信頼リスト) として設定してください。
(2)この機能を実現するため、スマートフォンシステムの認証管理プログラムで、「FitCloudPro」を信頼できるアプリとして設定し、通話者IDなどの機能に認証を取得する必要があります。

Q3: 電話の着信: デバイスにリマインダーが表示されますが、接続してもヘッドセットから音が聞こえないのですが?
A3: 着信があった後で、Bluetoothヘッドセットが反応するまで多少遅れが生じますが、数回着信音が鳴った後で応答することができるようになります。スマートフォンを通じて通話が接続される場合は、音声チャンネルが、スマートフォンとヘッドセットのどちらに切り替わっているか、確認してください。スマートフォンがヘッドセットに切り替わっている場合、原則的に、どのデバイスがどのデバイスに接続されているか、どのデバイスで応答したらよいか、確認してください。

Q4: ヘッドフォンを着用しているにもかかわらず?電話をかけようとしても呼出音が聞こえませんが?
A4: ヘッドセットとスマ?トフォンとの距離が?有効なBluetooth接続距離より短いことを確認してください?1台のスマ?トフォンが2台以上のBluetooth?バイスに接続されている場合?スマ?トフォンのBluetooth設定で?無効な接続を消去してください?

78 基本パラメータ

メインコントロールチップ：RTL8762D
本体重量：57g
Bluetoothのバージョン：Bluetooth 5.0、Bluetooth 4.0
バッテリーの種類：ポリマーリチウムバッテリー
バッテリー容量：充電モジュール205mAh、ヘッドセット25mAh。
充電電圧：5V
充電電流：150mA
動作温度：-5～45℃

機器要件：
Android 4.4以降、および、Bluetooth 4.0以降のAndroidスマートフォン。iOS 8.0以降のシステム、iPhone 4S以降のiPhone。

このアプリケーションは医療機器ではありません。このアプリケーションを使用している間に取得されたデータは、参照用としてのみ使用され、臨床診断、医学的研究、診断、または治療目的では使用されません。